


Air Quality Monitor 取扱説明書

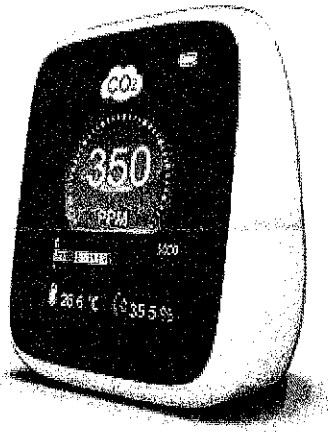

パッケージ内容物

- ①測定器本体 ×1
- ②USB充電ケーブル ×1
- ③取扱説明書 ×1

●製品仕様

表示方法：液晶ディスプレイ
動作環境：大気圧 86Kpa-106Kpa
測定間隔：1.5秒毎
測定項目：二酸化炭素 (CO2)、温度、湿度
CO2センサー方式：非分散型赤外線 (NDIR)
内蔵電源：1600mAh 大容量リチウム電池
入力充電：DC5V (ACアダプター付属なし)
外形寸法：70 × 80 × 35mm
製品重量：150g

●製品特徴

- ドイツ製の高精度・高感度センサー
- リアルタイム測定
- 面倒な設定不要
- USB充電
- 電池残量表示、電池低下警告音

●製品用途

- 本製品は、二酸化炭素、温度、湿度のリアルタイム測定・表示ができ、換気の目安としてご使用いただけます。
- 二酸化炭素濃度の危機管理や医療関連用途等は意図していません。
本製品での数値、またそれを利用した結果は、弊社が保証するものではありません。
- 機器1台の推奨使用範囲はおよそ30㎡となります。それより広い空間は、複数台が必要になります。


●ご使用前に

- 安全にご使用いただくため、説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 正しい測定結果を出すため、使用前に換気の良い場所で数分間作動させて下さい。
- この説明書は、お読みいただいた後も大切に保管してください。

●注意事項

- 不正確な測定を避けるために、使用中は通気口を塞がないようにしてください。
お手入れの際は、電源を切りUSBを抜いてから乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。
- 高温多湿や磁気が発生する場所でのご使用・保管は避けてください。
- 本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。
- 強い振動や衝撃を受けると故障・破損するリスクがあります。

Air Quality Monitor 取扱説明書

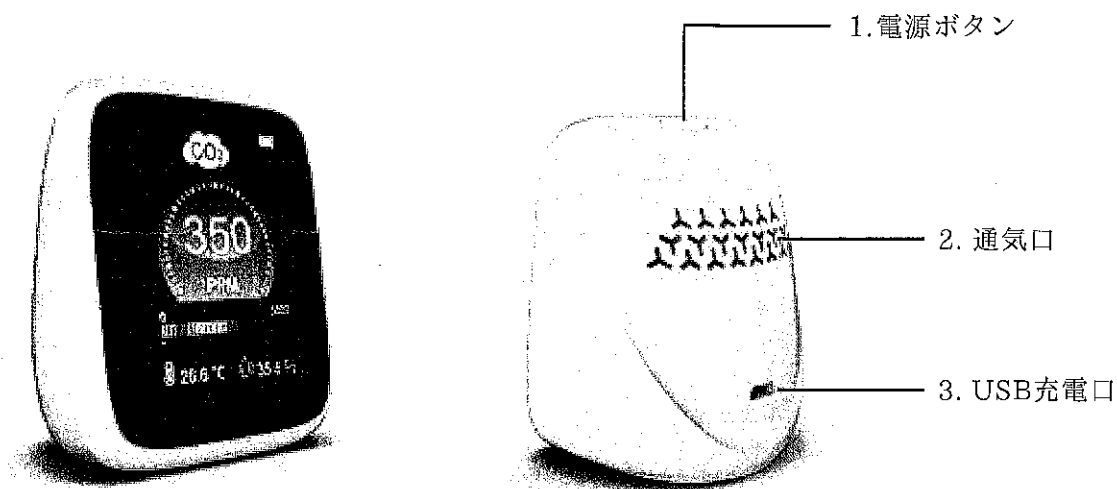

●使用方法

1. スタート

- 電源ボタンを軽く押すと電源がオンになります。
- 電源ボタンを3秒以上長押しすると電源がオフになります。
- 電源がオンの時、電源ボタンを押すと、摂氏温度と華氏温度が切り替わります。

2. 充電

- バッテリー低下のアイコンが表示されたら、充電してください。
- フル充電は2～3時間 (5V/1A出力の充電器を使用する場合)を要します。

●測定範囲

二酸化炭素濃度

測定範囲：400-5000ppm

単位：1ppm

温度

測定範囲：-10°C - 50°C

測定精度：±1°C

湿度

測定範囲：20% - 85%RH

測定精度：±4%RH

※厚生労働省推奨基準

厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度 (CO₂濃度) 1,000ppm以下が提示されています。